

FRESENIUS MEDİKAL HİZMETLER A.Ş. – PERİTON DİYALİZ TEDAVİSİNDE AYAKTAN TEDAVİ KAPSAMINDA KULLANILAN TIBBİ SARF MALZEMELERİ İÇİN


ÜTS BAYİLİK BAŞVURUSU

1. Aşağıdaki linkten ÜTS Sistemine erişim sağlanır.


<https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/>



2. "ÜTS GİRİŞ" tıklanarak E-İmza, E-Devlet veya Mobil İmza seçeneklerinden biri ile sisteme giriş sağlanır.

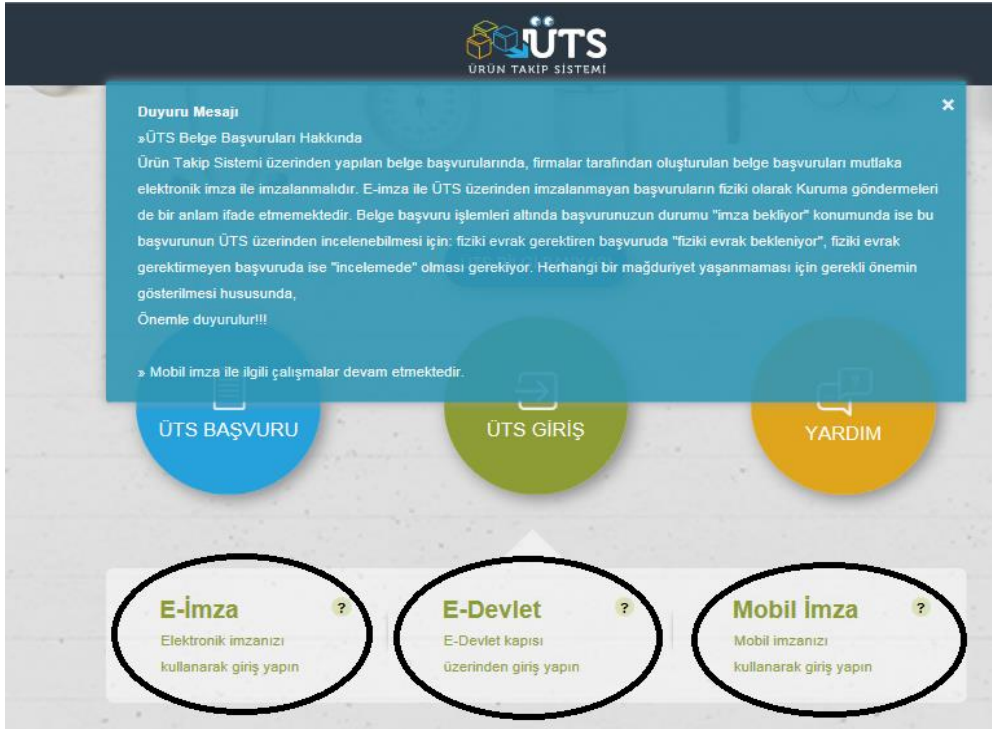


3. Açılan ekranda Bayilik bölümü altındaki “Alınan Bayilikler” butonu seçilir.

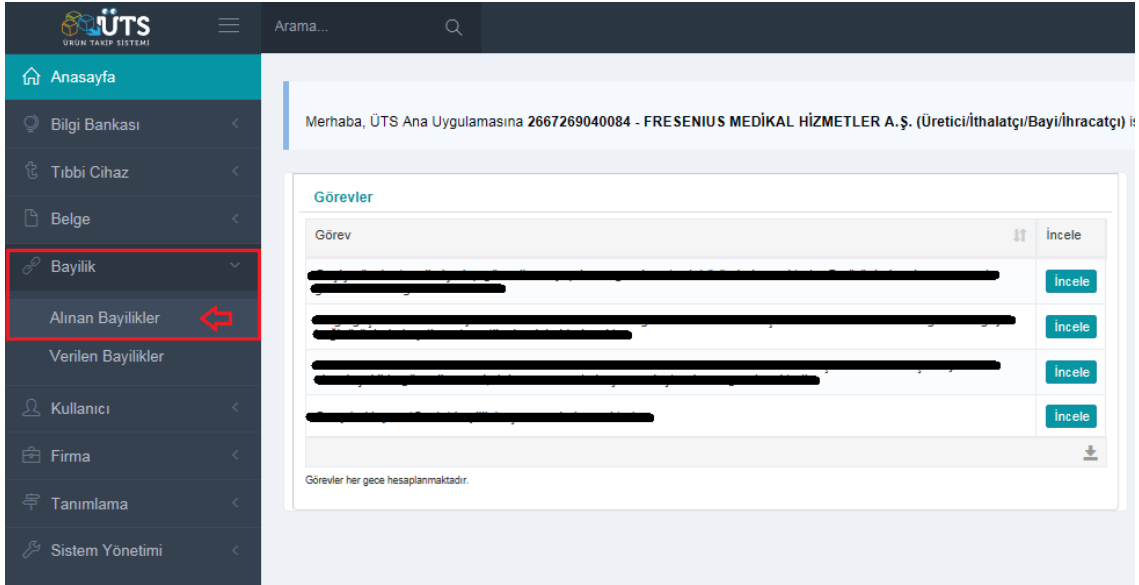


The screenshot shows the ÜTS Ana Uygulaması interface. The left sidebar contains a menu with the following items: Anasayfa, Bilgi Bankası, Tıbbi Cihaz, Belge, Bayilik (highlighted in red), Alınan Bayilikler (highlighted in red with a red arrow), Verilen Bayilikler, Kullanıcı, Firma, Tanımlama, and Sistem Yönetimi. The main content area displays a greeting: "Merhaba, ÜTS Ana Uygulamasına 2667269040084 - FRESENIUS MEDİKAL HİZMETLER A.Ş. (Üretici/İthalatçı/Bayi/İhracatçı) i". Below this, there is a section titled "Görevler" with a table of tasks. The table has columns for "Görev" and "İncele". There are four rows of tasks, each with a redacted "Görev" and an "İncele" button. At the bottom of the table, it says "Görevler her gece hesaplanmaktadır."

4. Aşağıdaki gibi açılan ekranın sağ üst köşesindeki “Bayilik Başvurusu Ekle” butonu seçilir.

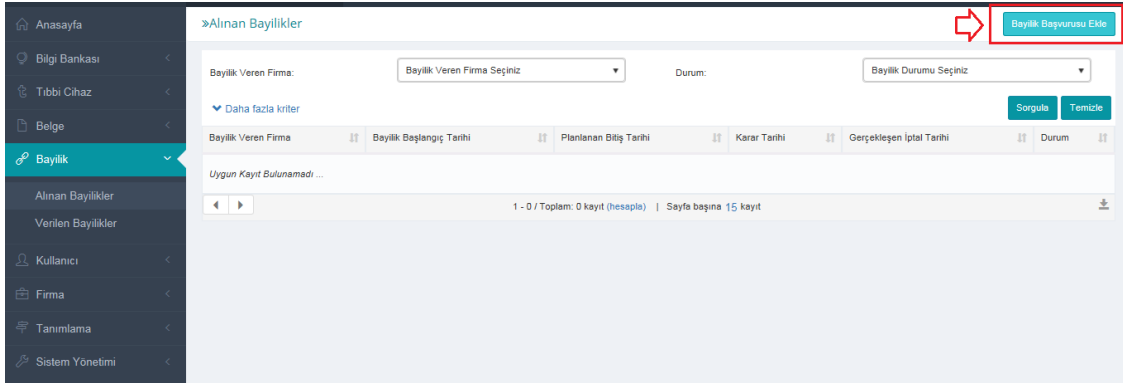


The screenshot shows the "Alınan Bayilikler" screen. The left sidebar is the same as in the previous screenshot. The main content area has a header "»Alınan Bayilikler" and a "Bayilik Başvurusu Ekle" button highlighted in red. Below the header, there are two dropdown menus: "Bayilik Veren Firma:" with "Bayilik Veren Firma Seçiniz" and "Durum:" with "Bayilik Durumu Seçiniz". There are also "Sorgula" and "Temizle" buttons. Below this, there is a table with columns: "Bayilik Veren Firma", "Bayilik Başlangıç Tarihi", "Planlanan Bilgi Tarihi", "Karar Tarihi", "Gerçekleşen İptal Tarihi", and "Durum". The table is currently empty, showing "Uygun Kayıt Bulunamadı ...". At the bottom, there is a pagination bar: "1 - 0 / Toplam: 0 kayıt (hesapla) | Sayfa başına 15 kayıt".

5. Firma Seçiminde; “FRESENIUS MEDİKAL HİZMETLER A.Ş.” firması seçilir. Seçim

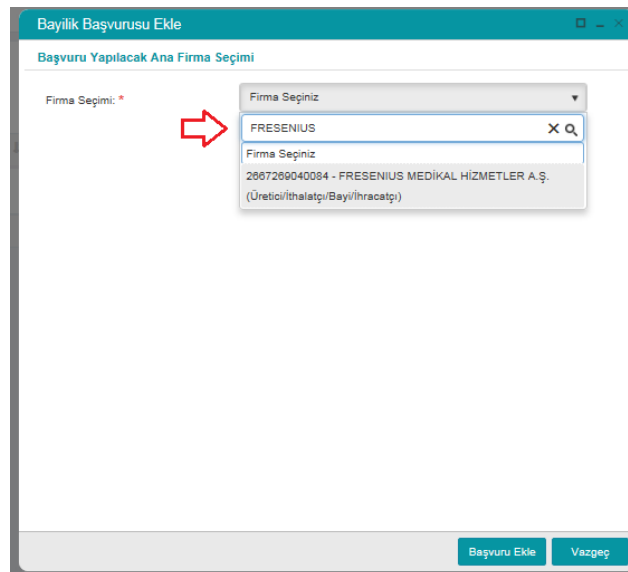


The screenshot shows the "Bayilik Başvurusu Ekle" dialog box. The title is "Bayilik Başvurusu Ekle" and the subtitle is "Başvuru Yapılacak Ana Firma Seçimi". There is a label "Firma Seçimi: *" and a dropdown menu "Firma Seçiniz" with "FRESENIUS" selected. A red arrow points to the dropdown menu. Below the dropdown, there is a search box with "FRESENIUS" and a search icon. Below the search box, there is a list of search results: "FRESENIUS" and "2667269040084 - FRESENIUS MEDİKAL HİZMETLER A.Ş. (Üretici/İthalatçı/Bayi/İhracatçı)". At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Başvuru Ekle" and "Vazgeç".

6. Bayilik süresi 2 yıl olacak şekilde Başlangıç ve Bitiş tarihleri seçilir. Ardından, Eczanenin bulunduğu il seçilir ve “Ürün Seç” tıklararak ÜTS de kayıtlı olan tüm ürünlerimiz listelenir. **(Önemli Not: “Mevcut ürünlerine başvurmak istiyorum” kutucuğu işaretlenmemelidir.)**

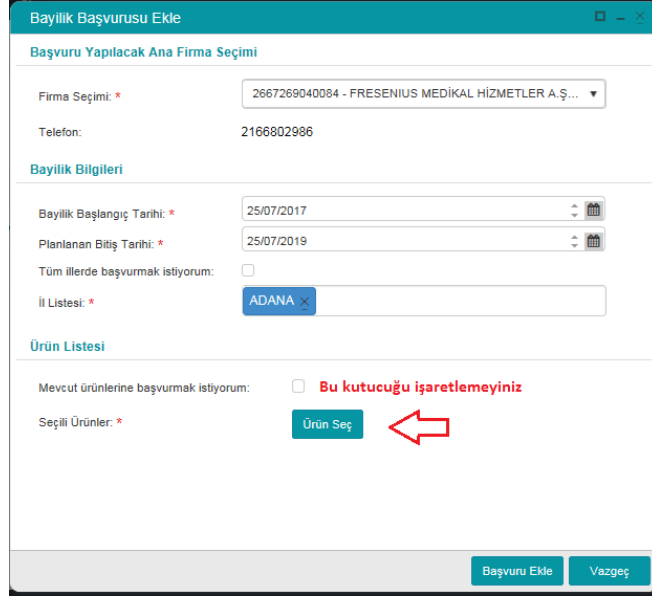

7. Listelenen ürünler arasından aşağıdaki gibi yalnızca ayaktan tedavi kapsamında bulunan Periton Diyalizi ile ilgili **7 ürün** seçilir. Ürün barkodları ayrıca tablonun altında yer almaktadır. **Not: ÜTS'de kayıtlı ürün sayımız yakın zamanda artacağından “Ürün Numarası” kısmına ürünün barkodunun yazılarak sorgulanması önerilir. Bayilik başvurunuzda 7 ürüne aynı anda başvuru yapmanız önerilmektedir.**

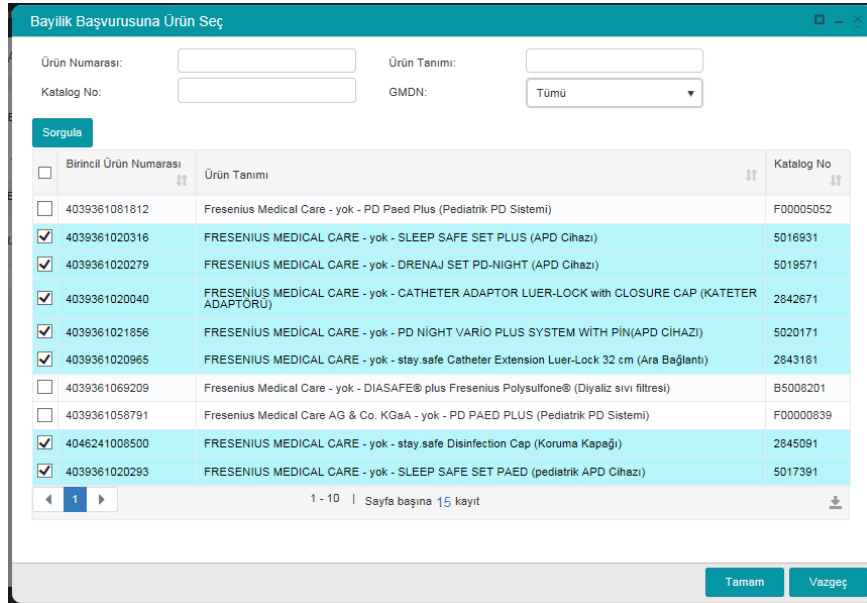

Ürün Numarası	Ürün Tanımı
4039361020040	CATHETER ADAPTOR LUER-LOCK with CLOSURE CAP (KATETER ADAPTORÜ)
4039361021856	PD NIGHT VARIO PLUS SYSTEM WITH PIN(APD CİHAZI)
4039361020279	DRENAJ SET PD-NIGHT (APD Cihazı)
4039361020293	SLEEP SAFE SET PAED (pediatrik APD Cihazı)
4039361020316	SLEEP SAFE SET PLUS (APD Cihazı)
4039361020965	stay.safe Catheter Extension Luer-Lock 32 cm (Ara Bağlantı)
4046241008500	stay.safe Disinfection Cap (Koruma Kapağı)

8. “Başvuru Ekle” tıklanır. Gün içinde başvurunuz firmamız tarafından değerlendirilecektir. ÜTS sistemi üzerinden başvurunuzun durumunu (Onay veya Ret) kontrol edebilirsiniz.

Bayilik Başvurusu Ekle

Ürün Listesi

Mevcut ürünlere başvurmak istiyorum:

Seçili Ürünler: * [Ürün Seç](#)

Ürün No	Ürün Tanımı	Ürün Tipi	Çıkar
4039361020040	FRESENIUS MEDICAL CARE - yok - CATHETER ADAPTOR LUER-LOCK with CLOSURE CAP (KATETER ADAPTORU)		Çıkar
4039361021856	FRESENIUS MEDICAL CARE - yok - PD NIGHT VARIO PLUS SYSTEM WITH PIN(APD CİHAZI)		Çıkar
4039361020279	FRESENIUS MEDICAL CARE - yok - DRENAJ SET PD-NIGHT (APD Cihazı)		Çıkar
4039361020293	FRESENIUS MEDICAL CARE - yok - SLEEP SAFE SET PAED (pediatrik APD Cihazı)		Çıkar
4039361020316	FRESENIUS MEDICAL CARE - yok - SLEEP SAFE SET PLUS (APD Cihazı)		Çıkar
4039361020905	FRESENIUS MEDICAL CARE - yok - stay safe Catheter Extension Luer-Lock 32 cm (Ara Bağlantı)		Çıkar
4046241008500	FRESENIUS MEDICAL CARE - yok - stay.safe Disinfection Cap (Koruma Kapağı)		Çıkar

1 - 7 | Sayfa başına 10 kayıt

[Başvuru Ekle](#) [Vazgeç](#)